# BETACHEK G5

## INSTRUCCIONES DE USO ABREVIADAS

**Producto para autodiagnóstico**

**Por favor lea detenidamente y de manera completa el Manual del Usuario del medidor antes de utilizar el aparato por primera vez.**

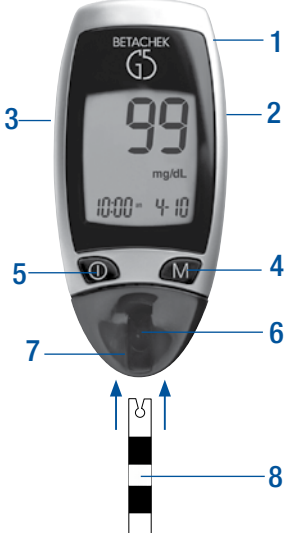


1. Cubierta de la batería (en la cara inferior)
2. Ranura para sacar la tarjeta de memoria (en la cara inferior)
3. Ranura de la tarjeta de memoria
4. Botón de recuperación de la memoria.
5. Botón de encendido/apagado
6. Medidor óptico
7. Guía de la tira de prueba
8. Zona de prueba

## Antes de comenzar

Antes de usar su glucómetro por primera vez, retire la tira plástica del compartimento de la batería tal como se muestra en la sección 'Antes de comenzar' en el Manual del Usuario.

## Codificación del medidor

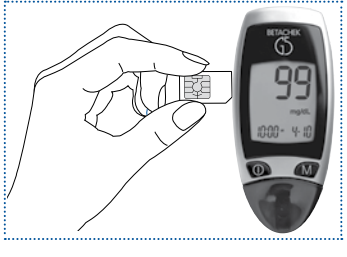


Cada envase de tiras viene con una tarjeta de memoria que debe ser insertada en el medidor antes de que se desarrolle cualquier prueba.

Además de almacenar los resultados, la tarjeta de memoria programa el medidor para que lea las tiras de prueba correctamente.

Cada tarjeta de memoria tiene un número de tres dígitos impreso llamado número de código. El número de código también esta impreso en el frasco de la tira de prueba. Antes de insertar la tarjeta de memoria el medidor mostrará tres barras y parpadeará la palabra CODE.

**Paso 1: Inserte la tarjeta de memoria**
Tome la tarjeta de memoria del envase de las tiras de prueba e insértela en el medidor.

El medidor hará un sonido cuando la tarjeta sea correctamente insertada y la codificación esté completa.

**Paso 2: Verifique el número de código**
El medidor mostrará un número de código de tres dígitos. Compruebe que el número mostrado en la pantalla concuerda con el número impreso en el contenedor de las tiras de prueba y la tarjeta de memoria.

NDP National Diagnotic Products
39 Herbert St, St Leonards
Sydney, NSW, 2065, Australia

EC REP Welkang Ltd
29 Harley St. London, UK

Distribuido en España por:
Generis Farmacêutica, S.A.
Office Park da Beloura, Edifício 4
2710-444 Sintra, Portugal

www.betachek.com

## Desarrollo de la prueba

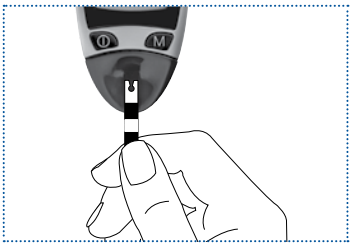


**Paso 1: Insertar la tira de prueba**
Inserte la tira de prueba en el medidor. El medidor se encenderá automáticamente.
**Nota:** Sostenga la tira por el centro TAL COMO SE MUESTRA en la figura.
**Precaución:** Inserte la tira completamente en el medidor.
**NO** arrugue o doble la tira ya que esto la dañará.

**Paso 2: Aplicar la sangre en la tira**
Cuando el símbolo de la sangre aparezca en la pantalla, aplique una gota de sangre en el centro de la zona de prueba (entre las dos cintas negras). Nota: La sangre debe ser aplicada cuando la tira esté dentro del medidor. Sí puede tocar la zona de prueba.
Una gota pequeña (1-2µl) es todo lo que se necesita. La zona de prueba debe cubrirse completamente, de lo contrario pueden obtenerse falsas lecturas.

Cuando una gota de sangre se aplique, el medidor emitirá un "bip" y comenzará a medir. No reitre la tira ya que esto conducirá a un resultado incorrecto. El resultado aparecerá con fecha y hora y será almacenado automáticamente.

El medidor G5 mide los niveles de glucosa entre 10-500 mg/dL (0,6 –27,7 mmol/L). Los valores fuera de este rango serán mostrados como "Lo"(bajo) o "Hi" (alto).

## Claves de los mensajes de error

**E-0** **Error EMC** (Campo electromagnético) aléjelo de las fuentes posibles de electromagnetismo, por ejemplo: teléfono móvil, microondas.

**E-1** **Batería baja,** no se pueden realizar mas pruebas.

**E-2** **Error de calibración,** devuélvalo al proveedor.

**E-3** **Verifique la tira.** Está usando una tira dañada o una tira usada o la tira no ha sido insertada completamente o los medidores ópticos están sucios.

**E-4** **Tarjeta de memoria llena.** Reemplace la tarjeta de memoria con la tarjeta incluida en el nuevo envase de tiras. Nota: Algunos modelos emitirán un sonido en lugar de mostrar E-4.

**E-5** **Hay luz ambiental en exceso** o la tira ha sido extraída durante la prueba. Aléjese de la luz solar directa.

**E-7** **Tira insertada incorrectamente o extraída durante la lectura del medidor.** Revise las instrucciones de prueba, inserte la tira gentilmente ANTES de encender el medidor y no mueva la tira una vez que la haya insertado.
**O Aplicó la sangre demasiado pronto**, repita la prueba y espere a que aparezca el icono de la gota de sangre.

**E-8** **La tira de prueba fue extraída** durante la prueba, repita la prueba y deje la tira en el medidor hasta que la prueba sea completada.

**E-9** **Tira de prueba defectuosa.** Verifique que ha almacenado y manejado las tiras de prueba tal como se indica en el prospecto.

**---** **Verifique que la tarjeta de memoria** no ha sido insertada adecuadamente o tiene un fallo.

**E-C** **Fallo en la tarjeta de memoria.** Retire la tarjeta y reinsértela. Si el problema persiste, no utilice la tarjeta o las tiras de prueba.

**tEt** **Temperatura incorrecta.** La pruebas no pueden desarrollarse fuera de los limites permitidos 5-45˚C (41 - 113˚F).

BG5QGEPS0509